


• **SPECIFICATION TECHNIQUES**

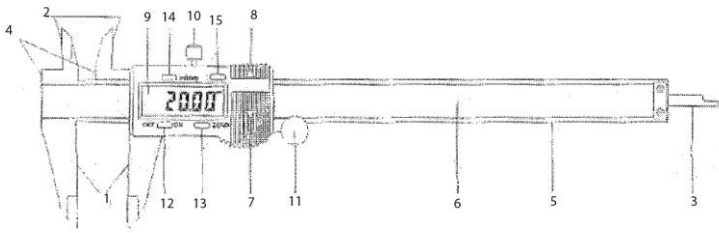

Capacité	Résolution	0-150mm/0-6 pouces, 0-200 mm/0-8 pouces, 0-300 mm/0-12 pouces
Précision		0.01 mm/0.0005 pouces
Repetabilité		± 0.02 mm/0.001 pouces (<100 mm)
Vitesse de mesure		± 0.03 mm/0.001 pouces (>100-200 mm)
Principe de mesure		± 0.04 mm/0.0015 pouces (>200-300 mm)
Affichage	Alimentation	0.01 mm/0.0005 pouces 1.5
Température	travail	m/sec, 60 pouces/sec
Humidité	travail	mesure linéaire capacitive

**LCD**

pile oxyde d'argent 1.55 V type SR44, capacité 180 mA/H  
5°C - 40°C /41 - 104 °F pas important en dessous de  
80% d'humidité relative

**NOMENCLATURE**

1. Faces de mesure	2. Faces de mesure extérieures	intérieures
	3. Jauge de profondeur	4. Faces de mesure de tête
	5. Règle	6.. Echelle
	7. Compartiment pile	8. Connecteur RS232
	9. Afficheur LCD	10. Vis de blocage
	11. Mollette de pouce (suivant modèle)	12. Bouton Marche/Arrêt
	13. Bouton remise à zéro	14. Bouton conversion mm/pouces
	15. bouton HOLD	

• **APPLICATIONS**

1. PREPARATION :

- (1) Le coulisseau ne peut être bougé que si la vis de blocage (N°10) est desserrée.
- (2) Nettoyer toutes les surfaces de mesures avec un chiffon sec et propre.
- (3) Vérifier que tous les boutons fonctionnent

2. METHODES DE MESURES :

- (1) Desserrer la vis (N°10).
- (2) Mettre en service l'appareil avec le bouton 12, puis choisir l'unité de mesure avec le bouton 14, chaque pression sur ce bouton change l'unité d'affichage.
- (3) Appliquer une pression normale sur le coulisseau pour fermer complètement les becs, puis presser le bouton 13 pour mettre l'appareil à zéro.
- (4) Lors d'une mesure, Pressez la touche 14 pour figer l'affichage, pressez encore cette touche pour revenir en mode normal.

## MANTENANCE

L'appareil doit toujours être propre et Nettoyer les faces de mesures avec un chiffon en coton et ne jamais utiliser de solvant ou autre  
 Pour économiser la pile, éteindre l'appareil après utilisation.  
 Ne pas exposer l'appareil à des champs ou courant électriques.  
 Pour autres instructions, se référer à votre revendeur

- **REPLACEMENT DE LA PILE**

Si l'affichage clignote, cela indique que le niveau de la pile est faible. Enlever le couvercle de l'emplacement de la pile en suivant le sens de la flèche situé dessus, mettre une nouvelle pile avec le + vers l'extérieur.

- **DEFAUTS**

DEFAUTS	CAUSE	MESURE
Cinq chiffres clignotent simultanément	Voltage de la pile inférieur à 1,45V	Changer la pile
L'affichage ne change pas lors du déplacement du coulisseau	Erreur électronique	Enlever la pile puis replacer la après 30 sec
Precision de l'ordre de 0,1 mm	Saleté dans le coulisseau	Enlever le couvercle du coulisseau et nettoyer à l'air comprimé 5kg.cm
Pas d'affichage	Voltage de la pile inférieur à 1,4V mauvais contact	Changer la pile, nettoyer les contacts de celle-ci

